

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび下記検査項目におきまして、改良新試薬の発売開始に伴い、現試薬が販売中止となる旨、試薬メーカーより連絡がありました。大変ご迷惑をおかけしますが、変更させていただきたくご案内いたします。  
何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬白

### 記

#### ■ 実施日

2017年6月1日（木）ご依頼分より

#### ■ 変更項目

項目コード	項目名
C151 2	高感度 TNF- $\alpha$


## ●高感度TNF- $\alpha$

測定試薬の製造販売中止、より感度が向上された改良新試薬の発売に伴い、測定試薬を変更させていただきます。

新基準値は、メーカー参考値です。

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
C151 2	高感度TNF- $\alpha$	項目コード	5576 0	C151 2
		項目名称	TNF- $\alpha$ (高感度)	高感度TNF- $\alpha$
		基準値 (単位)	0.75~1.66 (参考値) (pg/mL)	0.6~2.8 (参考値) (pg/mL)
		報告範囲	0.15未満, 0.15~999000	0.5以下, 0.6~999000

### ▼現法と新法の比較

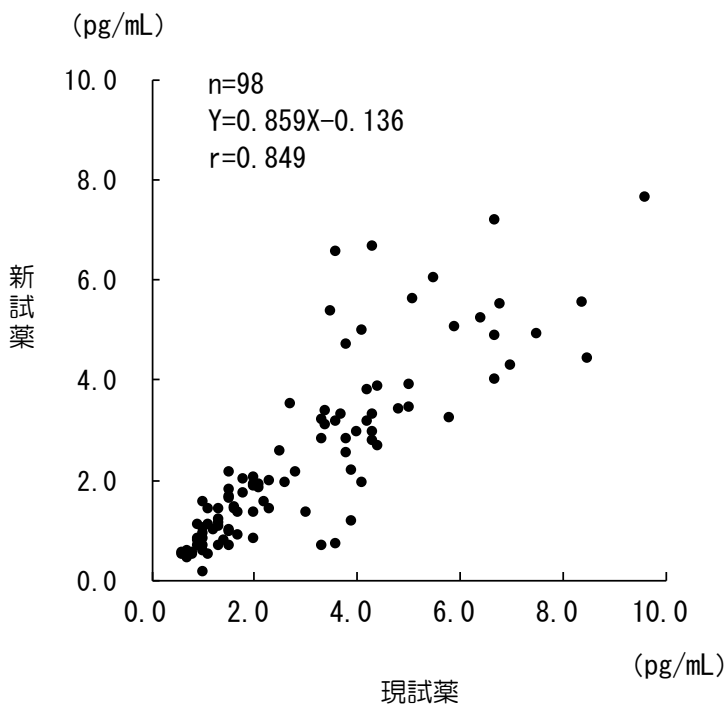

今回の新試薬への変更に伴い、現試薬にて測定しております下記項目コードは、受託中止とさせていただきます。

項目コード	項目名	受託中止日
C151 2	高感度 TNF- $\alpha$	2017年6月23日(金) ご依頼分をもって受託中止