

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
 このたび、試薬供給会社より下記検査項目に用いる基準物質を  
 WHO 1<sup>st</sup>から WHO 2<sup>nd</sup>に変更する旨、連絡がございました。  
 基準物質の変更に伴い、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。  
 何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■ 実施日 2018年2月2日（金）受付分より


■ 変更項目

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更内容	新	現
79	28050	HBs抗体 〔CLIA〕	基準値 (基準値)	(変更ありません。)	血清 10.0 未満 (mIU/mL)
			報告 範囲	2.5未満、2.5~999、 1000以上	10.0未満、10.0~499、 500以上
			備考欄	(基準値について) 10.0 mIU/mL は、HBV ワ クチンの再接種基準のため のカットオフ値です (最小 防御抗体価)。 抗体価の測定下限は 2.5 mIU/mL です。	(基準値について) 10.0 mIU/mL は、HBV ワクチンの再接種基準の ためのカットオフ値です (最小防御抗体価)。

### ▼現法と新法の比較

#### ●新検査方法参考文献

出口 松夫, 他: 医学と薬学 74 (9)  
:1137-1144, 2017.

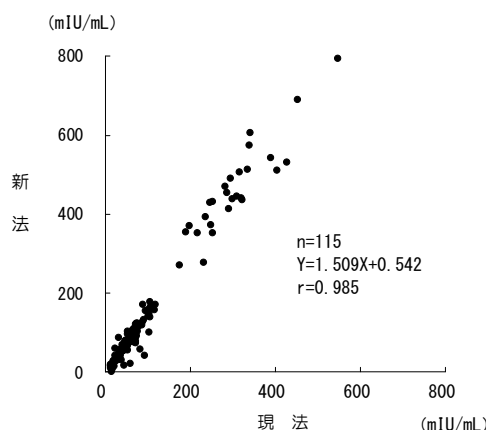

(報告下限値未満は除外しました。)